

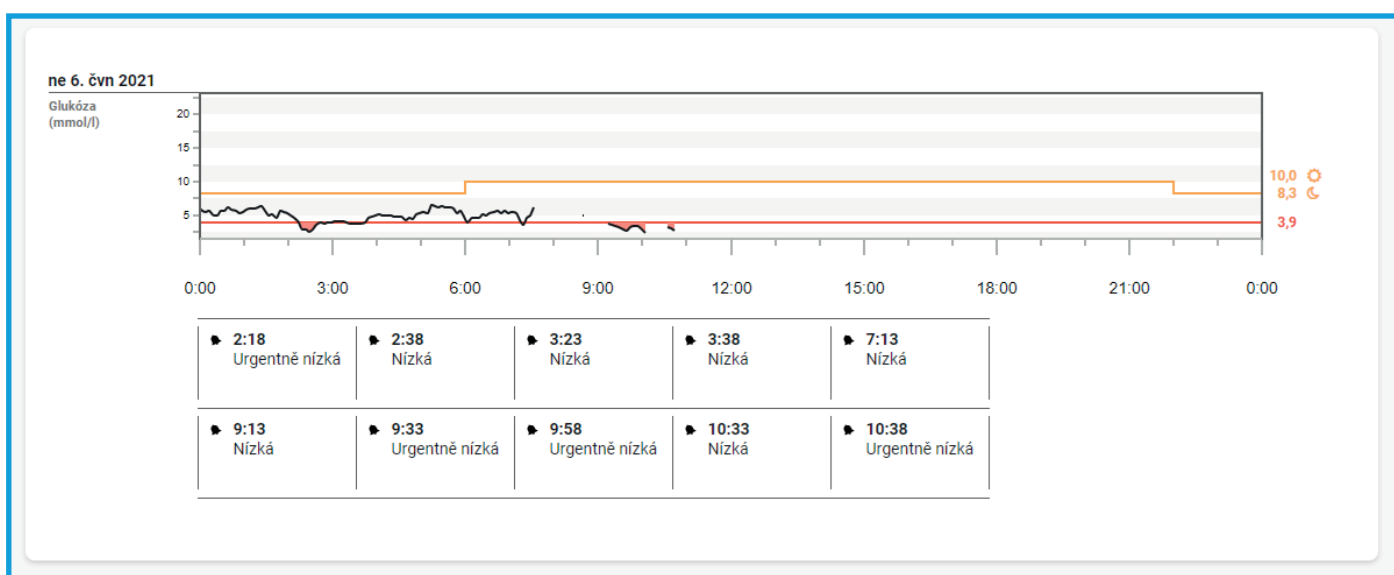
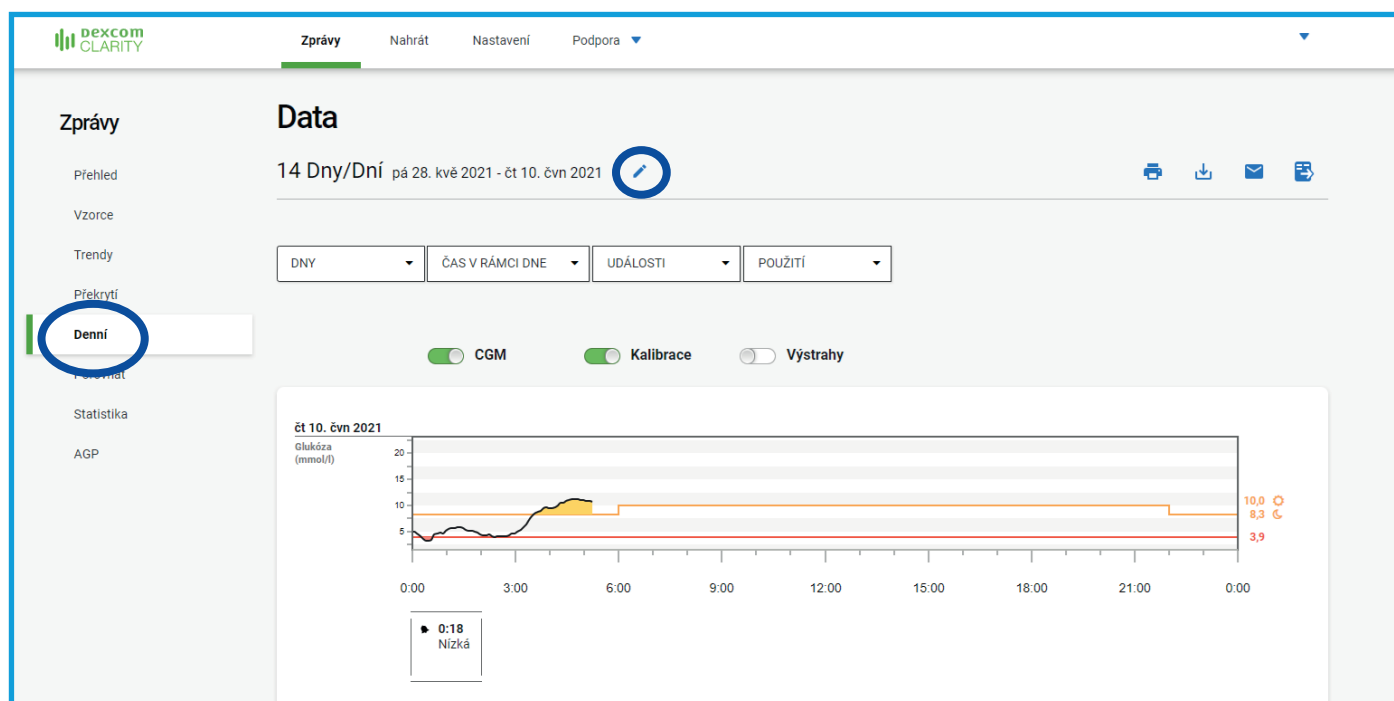


Vzory grafov - nutné k reklamácii

Graf z CLARITY:

Je nutné vybrat časový rozsah od dňa zavedenia senzora, až po jeho zlyhanie.

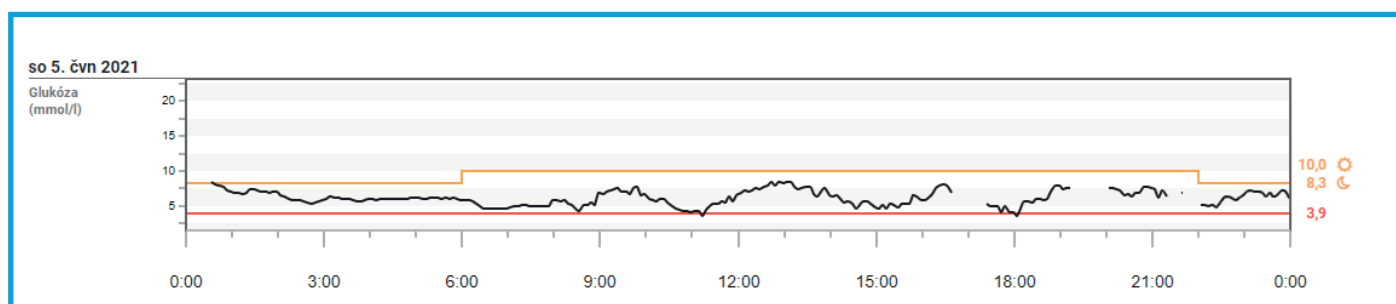

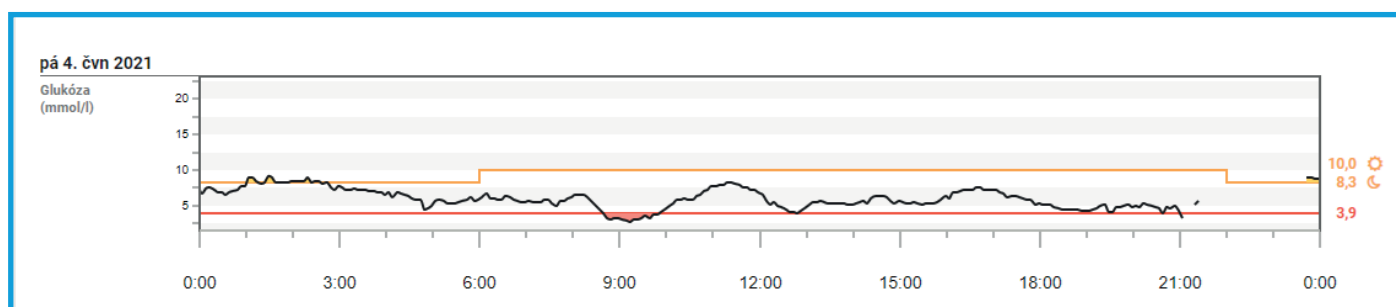

Graf z DIASENDU:

Uživatelé, ktorí majú iba inzulínovú pumpu a nepoužívajú mobilné aplikácie, prikladajú grafy z DIASENDU.

Vzory chybových hlášok z displeja telefónu alebo inzulínovej pumpy:

